

INFORMATION ご案内

検査試薬変更のお知らせ

病医院各位

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記の項目において測定機器および試薬を変更致します。

誠に勝手では御座いますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

【検査試薬変更】2019年 8月1日受付分より

インスリン	新		旧	
	測定方法	基準値	測定方法	基準値
	CLIA法	2.19~9.89 μ U/ml	ECLIA法	0.9~12.1 μ U/ml

メーカー指定基準値に変更に伴い、基準値の変更と負荷試験の基準値削除がございます。

NTproBNP	新		旧	
	測定方法	基準値	測定方法	基準値
	CLEIA法	カットオフ値 125pg/ml	ECLIA法	カットオフ値 125pg/ml

基準値の変更はございません。

ご不明の点等がございましたら、お気軽にお申し付け下さい。



チューケン長崎市医師会館ラボ


TEL 095-811-3131

URL:<http://www.chuken-group.co.jp>

相関図


NtproBNP

(pg/mL)

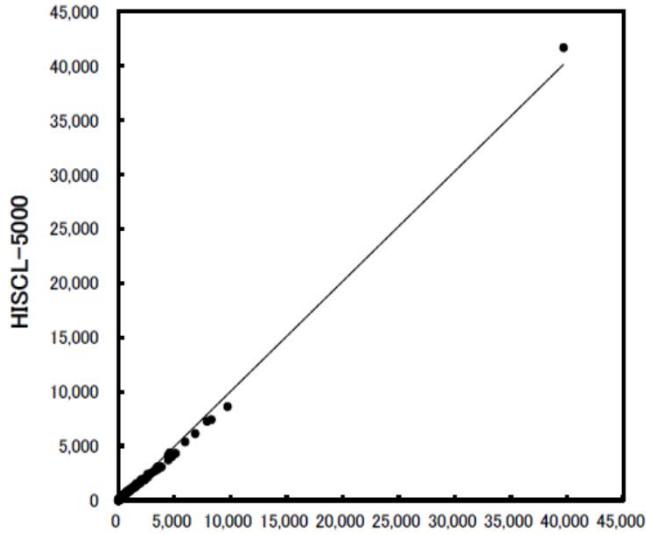

cobase411
 n = 161 y = 1.0142x - 123.9079
 X mean = 1312.5 r = 0.9972
 Y mean = 1207.23

インスリン

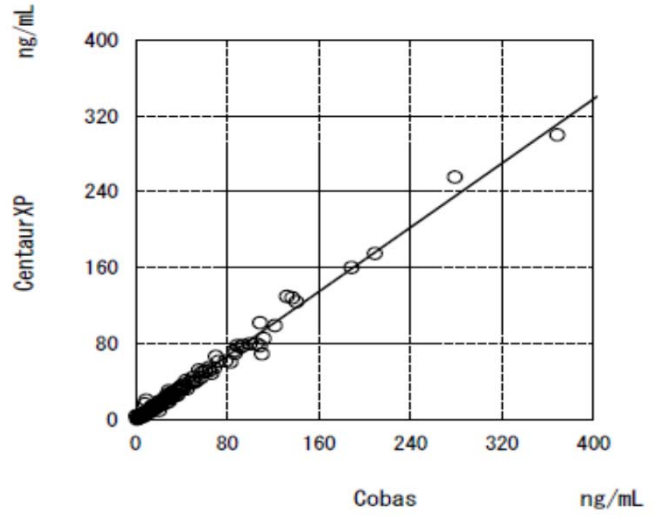

n =	162
y =	0.8444 x - 0.2372
r =	0.9942
Syx =	4.4260